PROTECTION pour le Wi-Fi, DECT, Bluetooth
CMO - WD17

Les principaux **symptômes du stress électromagnétique :**
Fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, maux de tête, problèmes de concentration.
Les CMO peuvent corriger ces symptômes de stress.*(Validation biologique réalisée sur plus de 1000 personnes, en double aveugle).*

Domaine d'application du CMO - WD17 :
Protection contre les rayonnements électromagnétiques des bases **Wi-Fi, téléphones sans fil DECT, liaisons Bluetooth**.

Les plages de fréquences des **fours à micro-ondes** (2,5 GHz) étant similaires, les WD17 couvriront donc également cette application.

Avec un CMO, ces équipements deviennent "bio-compatibles", c'est à dire compatibles avec les organismes vivants.

Mode d'emploi :
Le CMO - WD17 est à placer à l'intérieur de votre logement (ou de votre bureau), au centre de la zone à protéger, en hauteur (idéalement sur un meuble).

Le CMO - WD17 créé ainsi une zone de protection de 100 m², (ce qui correspond environ à une surface au sol de 11 mètres de diamètre autour du CMO, sur une hauteur de 5 mètres), et vous protège ainsi efficacement de ces stations émettrices.

Un seul CMO - WD17 est donc suffisant pour toute cette surface. Son action protectrice n'est pas stoppée par les cloisons d'appartement.

Le CMO - WD17 est de forme conique (7 cm à la base, 6 cm de haut), léger (175 grammes).
Le CMO - WD17 a été conçu avec une esthétique irréprochable, afin de s'intégrer parfaitement dans tout décor intérieur.

Il est préconisé de laisser une distance minimale d'1 mètre entre 2 CMO coniques.

Quelques résultats d'études :

Légende :

*Groupe **témoin** : ni exposé, ni protégé*

*Groupe **exposé** aux rayonnements du téléphone portable ou de l'écran d'ordinateur*

*Groupe **exposé** aux rayonnements et **protégé par Oscillation Magnétique de Compensation CMO***

Anticorps 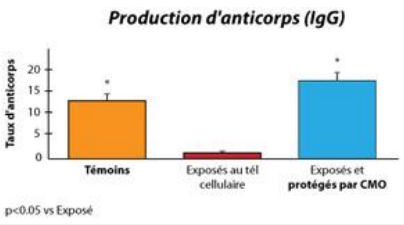 	Conséquences pathologiques possibles : - **Infections chroniques** - Fragilité des porteurs de virus à évolution lente **Quasi disparition** de la production des anticorps par rapport aux témoins non exposés. *Normalisation avec l'oscillateur magnétique de compensation CMO*
Mélatonine 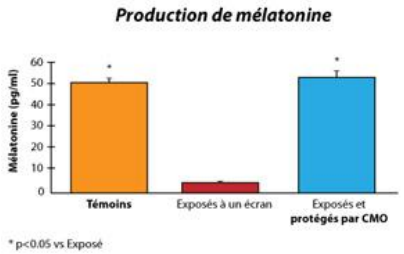 	**Conséquences pathologiques possibles :** **- Accélération du stress oxydatif** **- Vieillissement prématuré** **- Accélération d'un processus tumoral déjà engagé** **- Troubles du sommeil, fatigue, dépression.** **- Augmentation des crises épileptiques** **Quasi disparition de la production de mélatonine par rapport aux témoins non exposés.** ***Normalisation avec l'oscillateur magnétique de compensation CMO***
Mortalité embryonnaire	L'étude de la **mortalité embryonnaire** d'une espèce est un révélateur des anomalies apparues au cours de son développement et aboutissant à la mort. **59 % :** mortalité moyenne des embryons soumis à un téléphone portable, spectre complet **76 % :** mortalité moyenne des embryons soumis à un téléphone portable, micro-ondes filtrées *Normalisation avec l'oscillateur magnétique de compensation CMO.* **Suppression des micro-ondes** **= augmentation de la mortalité embryonnaire** Ici seules les extrêmement basses fréquences (ELF) provoquent l'effet toxique et sont la cause de la mortalité des embryons. **Ceci démontre le non-fondé des normes actuelles** (basées sur l'effet thermique des micro-ondes) qui préconisent une diminution

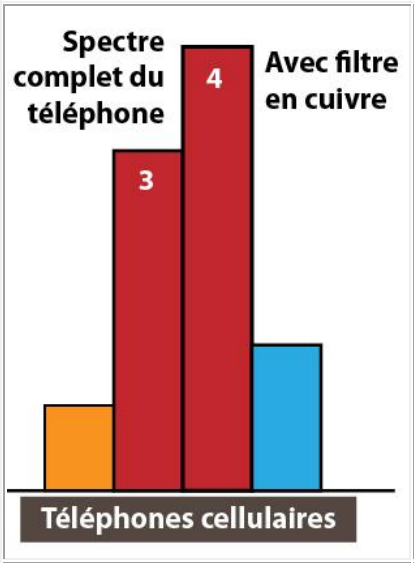	d'intensité des micro-ondes [normalisation par le DAS ou SAR] Même en situation d'exposition permanente (provoquant la mort des embryons pour leur grande majorité), l'oscillation de compensation est capable de maintenir ou protéger les processus vitaux fondamentaux. Avec un CMO le taux de mortalité est ramené quasi à celui d'embryons non-exposés, c'est-à-dire à la mortalité normale ou naturelle.
ADN 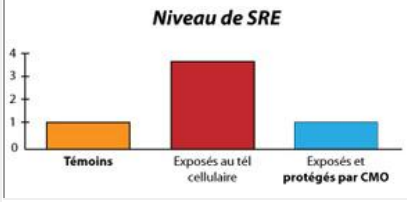	Le SRE (Serum Response Element) est la **séquence régulatrice de l'ADN.** **Mesurer le niveau de SRE permet de quantifier la croissance cellulaire.** Multiplication par **3,7** de la production de SRE par rapport aux témoins non exposés. *Normalisation avec l'oscillateur magnétique de compensation CMO.*
Calcium 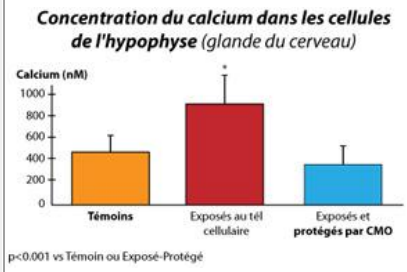	La répartition du **calcium** dans l'organisme est régulée par des hormones et l'exploration de son métabolisme peut permettre le **diagnostic de désordres hormonaux, de pathologies des os, de troubles rénaux touchant l'équilibre des ions de l'organisme.** Le calcium est également un médiateur (second messager) important de la plupart des réactions biochimiques intracellulaires. L'augmentation de la concentration en calcium dans l'hypophyse a pour conséquence une diminution du calcium disponible (calcium circulant dans le reste de l'organisme), et donc une **diminution de la capacité de réponse au stress.** **Conséquences pathologiques possibles :** - Modifications dans l'activité des enzymes intracellulaires - Déplacement des charges ioniques **(stress cellulaire)** - Modification du métabolisme - **Dérèglement hormonaux** possibles (thyroïde, surrénales, ovaires, ...) Multiplication par **2** de la concentration en calcium par rapport aux témoins non exposés. *Normalisation avec l'oscillateur magnétique de compensation CMO*
ACTH	Des variations anormales des taux sanguins de l'hormone adrénocorticotrope (**ACTH** = adrénocorticotropic hormone) et de glucocorticoïdes (corticostérone, cortisol) sont symptomatiques d'un **état de stress.** En outre, les glucocorticoïdes sont immunosuppresseurs, et chez le sujet sain, leur action immunosuppressive est contrebalancée par l'action immunostimulante de la mélatonine, ce qui assure le **maintien des paramètres biologiques** concernés dans les limites physiologiques (homéostasie). Conséquences pathologiques possibles :

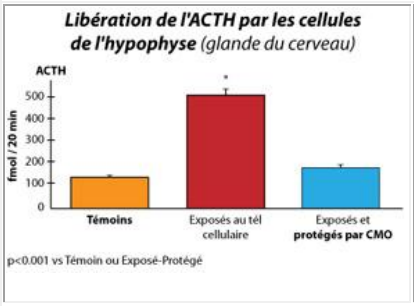	- Instabilité psychique, **irritabilité** - Tendance à la dépression - Faiblesse musculaire, crampes, contractures - **Baisse des défenses** contre les bactéries, virus, parasites, allergies - Aggravation des maladies inflammatoires Multiplication par **4** de la libération de l'hormone de stress par rapport aux témoins non exposés. *Normalisation avec l'oscillateur magnétique de compensation CMO*

On constate un retour à la normale des indicateurs biologiques pour les populations exposées aux rayonnements électromagnétiques et protégées par CMO.

Principe de fonctionnement :
Le principe de la technologie CMO (=Oscillateur Magnétique de Compensation) est de réémettre un signal de compensation hyperfaible (environ un million de fois plus faible que le rayonnement de votre téléphone), mais néanmoins **suffisant pour être perçu par l'organisme.**
Ces champs hyperfaibles entrent en résonance avec les récepteurs des organismes vivants, et vont maintenir, au niveau cellulaire, les liaisons ions-protéines perturbées par le champ polluant et ainsi **protéger le fonctionnement électromagnétique naturel des cellules** jusqu'aux organes, comme le cerveau ou l'œil.
Ces signaux s'opposent ainsi directement, en toute innocuité pour l'utilisateur, au stress électromagnétique généré par les rayonnements polluants. Le fonctionnement des cellules de l'organisme ainsi protégées n'est alors plus affecté par ce type de stress.

La technologie CMO n'augmente pas, ne réduit pas, n'absorbe pas ni ne modifie les rayonnements ou l'efficacité des appareils polluants : **ils n'agissent pas sur le fonctionnement des appareils électroniques**.
L'action de la technologie CMO se porte directement au niveau cellulaire.

La durée garantie de l'effet protecteur des CMO est de 2 ans. La durée de vie constatée est largement supérieure. Le renouvellement de votre CMO sera à envisager non pas au bout de 24 mois, mais lorsque vous constaterez une réapparition des symptômes de stress.

Le CMO est un système passif (autonome, et sans pile).

Fabrication :
Il n'existe qu'un seul et unique fabricant : tous les CMO que vous trouverez sur le marché sont fabriqués par la société Comosystems, qui en a la licence exclusive.

(*) **date de mise sur le marché de ce CMO**